

FICHE DE MESURES VERTICALISATEUR



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Société

Applicateur

Identification

Sexe Age Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité



Éléments fournis

- Fiche de mesures Fichier numérique
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures

Mesures

- Coque antérieure
- Coque postérieure
- Mesures finies
- Mesures + _____ mm

Mesures tête

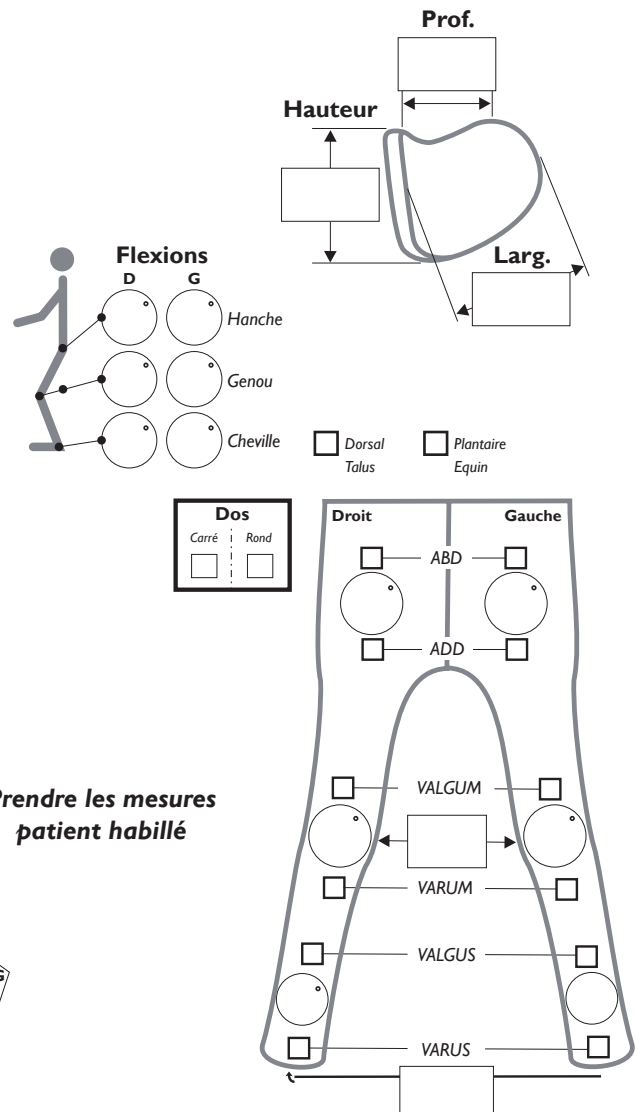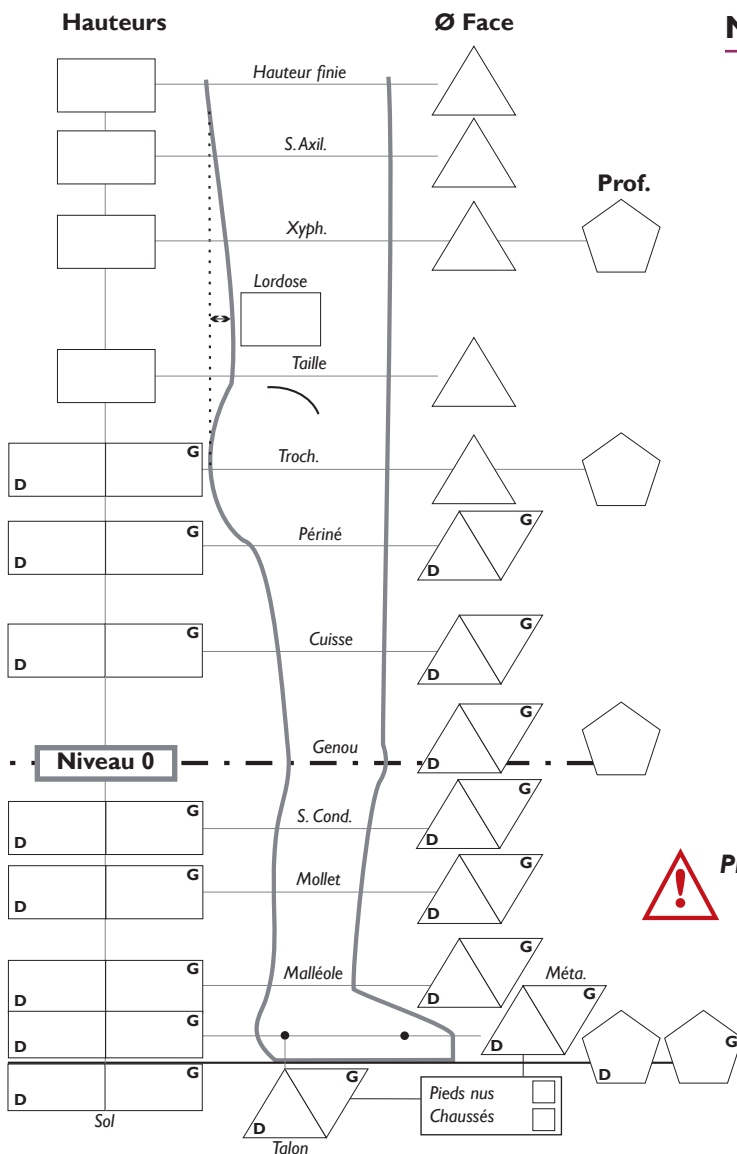

Prendre les mesures patient habillé

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Réf. CSM production

WWW.GROUPE-G2M.COM

BON DE COMMANDE VERTICALISATEUR



Polyhandicap **ORTHÈSES**

Demande de devis

Commande

Date

Société _____

Adresse de livraison _____

Applicateur

Contre marque

Délai souhaité

Observations _____

| Matière | Épaisseur |
|-----------------|-----------|
| Polyéthylène HP | |

| Mousse capiton | Couleur | Épaisseur |
|----------------|---------|-----------|
| Plastazote | | |
| Evazote | | |
| Mémoire | | |

| Papier de transfert |
|--|
| Indiquer la référence souhaitée (reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris) |
| Papier transfert fourni (cocher la case) |

| Garniture |
|----------------------|
| Plastron |
| Plastron à bretelles |
| Sangles bretelles |
| Sangles fémorales |
| Sangles abdominales |
| Sangles thoraciques |
| Fronde de genoux |
| Sangles de jambes |
| Sangles de pieds |
| Poignée |

| Couleur châssis | |
|-----------------|------------|
| Bleu foncé | Rose |
| Parme | Bleu clair |
| Vert | Rouge |
| Noir | |



| Références | Descriptif | Cde |
|---------------------------------|--|-----|
| SVS100 | Scanner moulage | |
| SVR100 | Rectification verticalisateur | |
| FRAISAGE VERTICALISATEUR | | |
| SVU100 | Fraisage verticalisateur monobloc standard H. 140 cm | |
| SVU200 | Fraisage verticalisateur monobloc hors standard | |
| THERMOFORMAGE | | |
| SVT110 | Thermoformage verticalisateur polyéthylène + plastazote | |
| SVT130 | Thermoformage verticalisateur polyéthylène + mousse de 30 mm | |
| HOUSSE | | |
| ST47HTF | Housse 3D thermoformée sur mesure | |
| SAT47HTF2 | Housse 3D thermoformée sur mesure assise ou dossier | |
| ADJONCTIONS | | |
| SAT47Z02 | Tétière amovible ou non | |
| SAT47Z03 | Tétière réglable au minimum dans les 2 plans | |
| SAT47Z3D | Tétière réglable au minimum dans les 3 plans | |
| SAT43Z18 | Mentonnière | |
| SAT47Z04 | Appui sous claviculaire rigide et réglable | |
| SAT47Z05 | Appui sternal rigide et réglable | |
| SAT47Z11JB | Tablette standard janton blanche | |
| SAT47Z11JT | Tablette standard janton transparente | |
| SAT47RS | Rallonge d'un segment jambier ou hanche | |
| SAT47AF | Adaptation et finition | |
| SAT47ABR | Adaptation sur base roulante verticalisateur | |
| SAT47FOC | Adaptation lumière et renfort rigidité | |
| SAT47Z06 | Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple | |
| SAT47Z14 | Dispositif de fixation du segment fémoral tibial pied | |
| SAT47Z10 | Cale de compensation de pied | |

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Observations

Opérateur

Date de livraison

WWW.GROUPE-G2M.COM